


# Osstell用クイックガイド




## 使用開始 - 全般



Osstell ISQモジュール



ケーブル付き測定用プローブ,  
テスト用ペグ, スマートペグマ  
ウント



カチッと音がして固定されるま  
で、Osstell ISQを押し込みます。  
👉 USBケーブルの位置に  
注意して下さい!



USBを接続します。




測定用プローブを接続します。  
👉 向きに注意して下さい!



ユニバーサルサポートを取り付  
けて固定します。

# Osstell用クイックガイド

## 測定結果

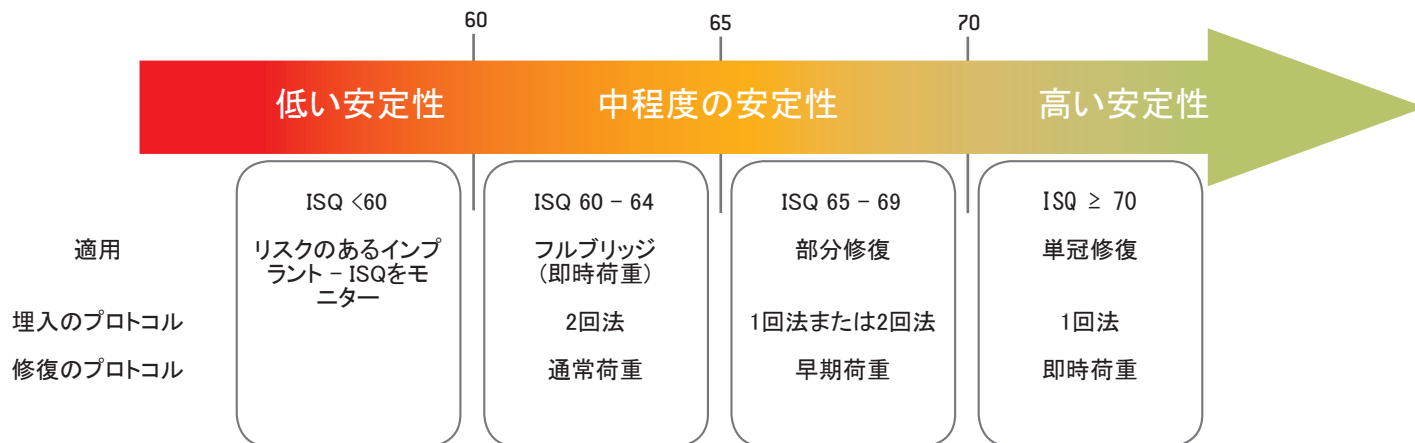

これは科学的データの概要であるため、公式な勧告を意味するものではありません。オッセオインテグレーションをモニタリングするには、インプラントの挿入後、およびインプラントの修復前に測定を行う必要があります。

科学的な研究についてはこちら[www.osstell.com](http://www.osstell.com)をご覧ください